

## **Внимательно прочтите инструкцию до конца**

### **Чистка и стерилизация**

1. Разберите бутылку на части. Отверните держатель соски и выньте вентиляционную систему (втулку и воронку).
2. Бутылочка, её компоненты и силиконовая соска — только перед первым использованием: стерилизуйте в кипящей воде в течение 3-х минут.
3. Тщательно вымойте все части в тёплой воде с использованием моющих средств. Используйте прилагаемый к изделию ёршик для чистки вентиляционной системы.
4. Прополощите все части, проверьте, чтобы отверстие соски было свободно и не засорено.
5. При мытье в посудомоечной машине все части изделия кладите в верхнюю корзину.
6. Стерилизуйте в стерилизаторе Dr. Brown's Natural Flow®.

### **Правила пользования (см. схему)**

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Без установки вентиляционной системы (втулки и воронки) изделие не будет работать!

1. Смесь должна быть смешана вне бутылочки. Смесь должна быть хорошо перемешана и не содержать комков и сгустков, которые могут перекрыть отверстие соски. Избегайте образования пузырьков. Не взбалтывайте содержимое бутылочки.

2. Залейте в бутылку необходимое количество смеси.

Помните, вентиляционная система не будет работать, если уровень смеси будет выше специальной отметки на бутылке.

3. Вставьте втулку в воронку.
4. Вставьте воронку в бутылку так, чтобы втулка плотно прилегала к горловине бутылки.
5. Вставьте соску в держатель и закрепите на бутылке.

6. Нагревание смеси в бутылке — всегда ослабляйте держатель соски на бутылке, чтобы предохранить вентиляционную систему от попадания вытекающей из-за повышения давления при нагревании жидкости.

7. Не нагревайте жидкость выше температуры тела (37°C).

8. Перед кормлением плотно затяните держатель соски на бутылке.

### **ВНИМАНИЕ**

1. Не рекомендуется использовать микроволновую камеру для подогревания смеси, так как это может привести к перегреву и образованию отдельных горячих участков. Если Вы пользуетесь микроволновой камерой, помните, что соска и держатель всегда должны быть сняты во время нагревания. Часто проверяйте температуру, капнув несколько капель на тыльную поверхность руки, после тщательного перемешивания для устранения неравномерного нагрева.

2. Слегка потяните соску перед каждым использованием (кормлением), чтобы убедиться, что она не рвётся. При первых признаках повреждения замените соску.

3. Всегда прекращайте кормление прежде, чем бутылочка опорожнится полностью, иначе Ваш младенец начнет засасывать воздух.

4. Бутылочку или её части не следует давать ребенку для игр.

5. По любым вопросам относительно кормления ребенка консультируйтесь у Вашего врача.

6. При транспортировке бутылочки всегда должны находиться в вертикальном положении.

Если Ваша новая бутылочка Доктор Браун имеет специфический запах, это безопасно. Бутылочка Доктор Браун и её компоненты, включая соску и части вентиляционной системы, сделаны из высококачественных и безвредных материалов, что отражено в сертификатах соответствия ГОСТ Р и СанПИН.


Для устранения запаха от новой полипропиленовой бутылочки либо её компонентов без риска его повторного появления необходимо проделать следующие действия:

Только перед первым мытьём и стерилизацией:

Растворить одну столовую ложку питьевой соды в ёмкости с тёплой водой, размешать, опустить бутылочку и части вентиляционной системы в ёмкость и оставить на ночь.

## **Бутылочка для кормления детей Dr. Brown's Natural Flow®**

### **Схема**

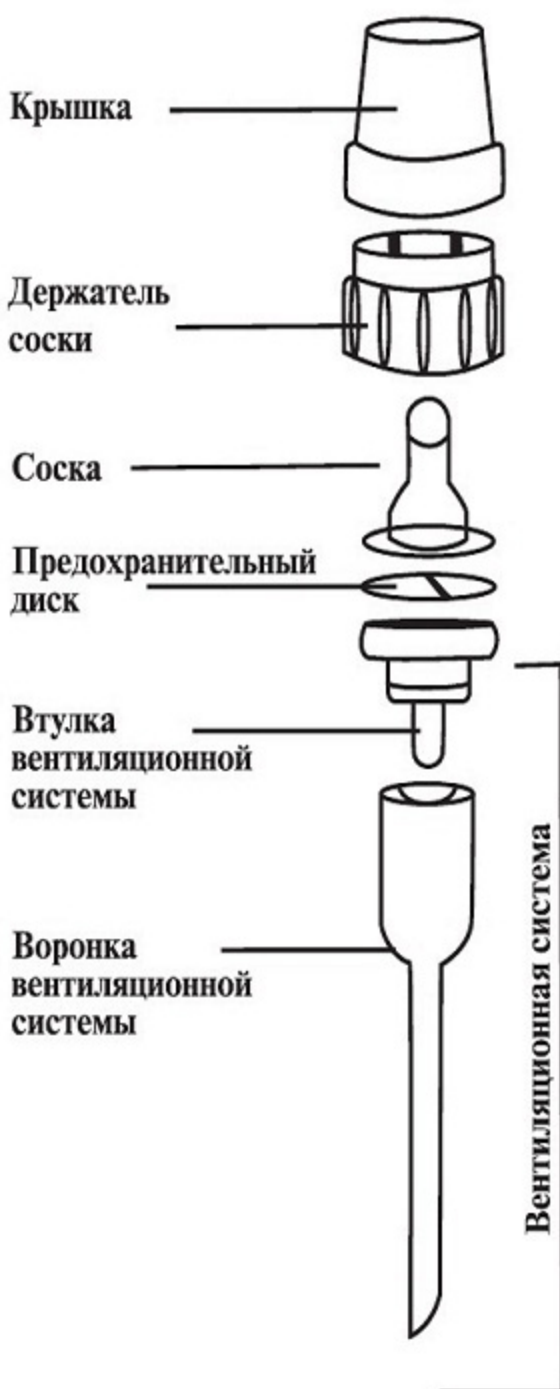

### **Памятка**

A. В комплект бутылочки Dr. Brown's Natural Flow® входит соска для новорожденных. Существуют также следующие уровни:

- медленный поток (для детей с ослабленными сосательными функциями),
- от 3-х месяцев,
- от 6-ти месяцев,
- для кормления жидкими кашами и соками с мякотью,
- от 12 месяцев.

Применяйте только соски Dr. Brown's Natural Flow®. Другие соски не смогут обеспечивать желаемый режим кормления.

B. При кормлении Вашего ребенка следите за тем, чтобы открытый конец воронки не был погружен в жидкость. Это обеспечивается углом наклона бутылочки приблизительно 45 градусов. Остающаяся в начале кормления в воронке жидкость при этом будет легко вытеснена.

C. При кормлении держите ребенка так, чтобы его голова была в немного приподнятом состоянии.

### **Dr. Brown's Natural Flow® Стеклобутылочки**

Стеклобутылочки могут разбиться. Бутылочки необходимо проверять непосредственно перед каждым использованием. Не используйте бутылочки, если на них имеются трещины или сколы.

Внезапное изменение температуры может вызвать раскол стекла либо его повреждение. Перед заполнением бутылочки удостоверьтесь, что бутылочка и жидкость приблизительно одинаковой температуры.